

kat. č. 215.02

Pracovní plochy

NEREZOVÉ PERFOROVANÉ STOLY POD LF




- Stoly jsou uzpůsobeny do čistých prostor třídy „D“, „C“ a „B pro místnosti ošetřené lokálním sestupným laminárním prouděním. Perforovaný stůl je sestaven z nerezové podnože a perforované pracovní desky. Pracovní desku nabízíme ve dvou materiálových variantách.
 - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304, povrch SB
 - Pracovní deska z nerezové oceli AISI 316, povrch SB
- Nosnost stolu je 100 kg - při rovnoměrném zatížení.
- Stoly je možno řetězit do sestav.
- Perforace pracovní desky minimálně 30%
- Pro zachování důležitých parametrů je v zadní části pracovní plochy zvýšena propustnost pro průchod vzduchu.
- Stůl je zeměn. Pro zemění stolu slouží zemní bod na zadních nohách ve výšce cca 200 mm od podlahy.

Rozměrová řada:

Šířka stolu - A (mm) 1035; 1250; 1850

Hloubka stolu - B (mm) 600

Výška stolu - C (mm) 750, 900

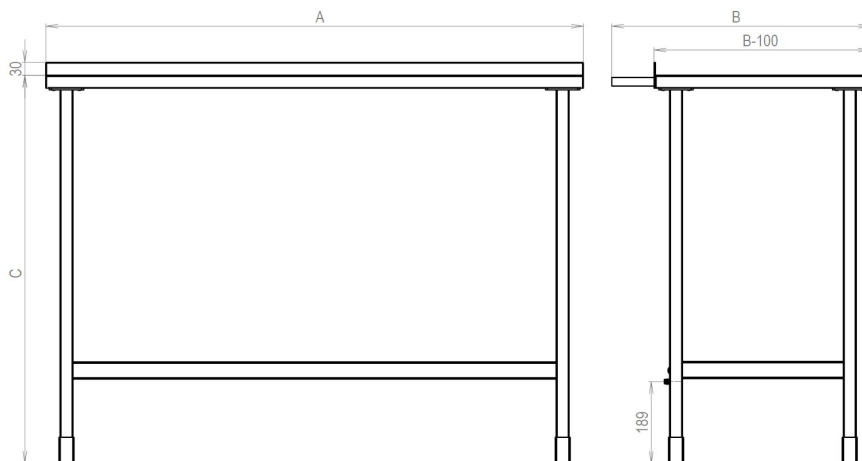

TECHNICKÁ DATA

Typové označení

Stůl pod laminár vhodný do GMP

Šířka A

| hodnota | šířka |
|-------------|---------|
| Šířka stolu | 1035 mm |
| Šířka stolu | 1250 mm |
| Šířka stolu | 1875 mm |

Hloubka B

| hodnota | hloubka |
|---------|---------|
| Hloubka | 600 mm |

Výška C

| hodnota | výška |
|-------------|--------|
| Výška stolu | 750 mm |
| Výška stolu | 900 mm |

Materiálové provedení desky stolu

| hodnota | materiál |
|--------------------|-----------------------------------|
| Povrch desky stolu | Nerezová ocel AISI 304 povrch SB |
| Povrch desky stolu | Nerezová ocel AISI 316L povrch SB |

Materiálové provedení kostry stolu

| hodnota | materiál |
|---------------------|--------------------------------|
| Povrch kostry stolu | Nerezová ocel AISI 304 brus SB |

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

